



Aksesuāri

Produkta nosaukums kompensējamo medicīnas ierīču sarakstā Id. Nr.	Iepakojums	Kompensācijas limiti
	Sion salvetes adhezīva noņemšanai 24/04-001/14-01	100 gab.
	Aerosols Esenta, adhezīva noņemšanai 24/04-006/14-01	50 ml
	Sion salvetes aizsargkārtas veidošanai 24/04-002/14-01	100 gab.
	Aerosols Esenta, aizsargkārtas veidošanai 24/04-004/14-01	50 ml
	Stomahesive ādu aizsargājoša pasta 10/04-073/13-01	Tūbiņa 60 g
	Stomahesive adhezīvais pulveris 10/04-072/13-01	25 g
	Presenta® peristomālo ādu aizsargājošs gels 24/04-005/14-01	50 ml
	Josta lietošanai ar Combihesive 2S stomu maisiņiem 10/04-060/13-01 Izrakstāma tikai divdaļīgajām sistēmām	1
	Stomasafe josta S/M (85-110 cm) 12/04-005/14-01 M/L (105-125 cm) 12/04-006/14-01 L/XL (120-140 cm) 12/04-007/14-01	1 gab. gadā

Visi izrakstāmo produktu daudzumi ir norādīti pamatojoties uz valsts noteiktajiem kompensācijas limitiem.

Viendabīgās sistēmas izrakstīšana

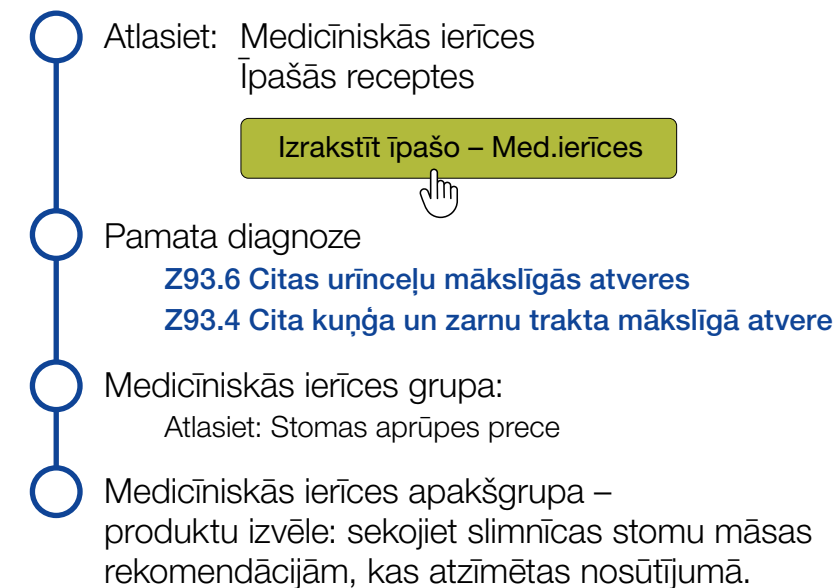

Pacientam pēcoperācijas periodā ir iespēja saņemt valsts
apmaksātu aprūpi mājās. Ģimenes ārsts izraksta nosūtījumu,
atbilstoši MK noteikumu Nr. 265 pielikumam Nr. 94.

Produkti

	Produkta nosaukums un apraksts	Stomas diametrs (mm)	Produkta izmērs un krāsas kods	Produkta nosaukums un Id. Nr. kompensējamo medicīnisko ierīču sarakstā		Limits vienam gadam	Recepte
	Stomadress® Plus viendaļīgs urostomas maisiņš	19–45 mm (griežams)	19 mm	Stomadress Plus viendaļīgi urostomas maisiņi 19 mm	10/04-067/13-01	360 gab.	90 gab. (9 kastes) 3 mēnešiem
		 32 mm	32 mm	Stomadress Plus viendaļīgi urostomas maisiņi 32 mm	10/04-068/13-01		
		 38 mm	38 mm	Stomadress Plus viendaļīgi urostomas maisiņi 38 mm	10/04-069/13-01		
	QE 4 urīna drenējamais nakts maiss tilpums 2 l			QE 4 urīna drenējamie nakts maiši, tilpums 2 l	24/04-003/14-01	30 gab.	10 gab. (1 iepak.) 4 mēnešiem



Stomu maisi jāmaina katru dienu. Uz nakti jāpievieno urīna nakts maiss.

Savienošanai izmantojiet adapteri, ko atradīsit urostomu maisu kastītē.

Viendalīgās sistēmas Stomadress Plus adapteris



Divdaļīgās sistēmas Natura+ adapteris



Limiti

Palīgs ģimenes ārstam

Kā ātri un pareizi
izrakstīt
UROSTOMAS
aprūpes
produktus



Pirmajā vizītē pie ģimenes ārsta,
uzreiz pēc operācijas pacientam izrakstāmi
visi aksesuāri un



Stomas diametrs mainās, sevišķi
pēcoperācijas periodā.

Pirmajā produktu izrakstīšanas reizē uzticieties tam
ko atzīmējusi slimnīcas māsiņa.

Atkārtoti izrakstot produktus, jautājiet pacientam
vai stomas diametrs ir mainījies un kāds tas ir.

Konsultācijas par stomas aprūpi, dzīvi ar stomu, produktu
lietošanu: Linus Medical informatīvais tālrunis **80005333**
Informatīvie materiāli un apraksti: **www.stomas.lv**